卓外 ZOLWISE

4K三维电子胸腹腔镜快速操作指南

设备说明

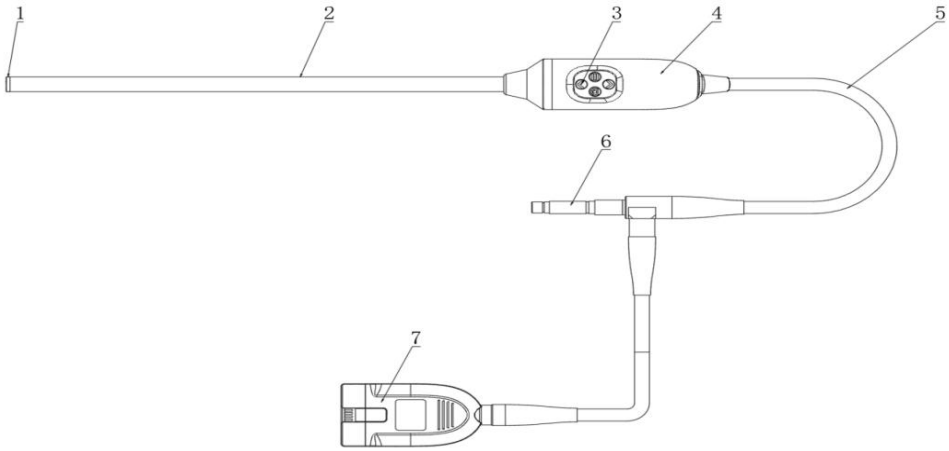

1-头端部；2-插入部；3-手持部（手柄按键）
4-手持部（手柄）；5-线缆；6-光源接头；7-排插

安装流程

1）在台车或其他固定场所安装内窥镜摄像系统设备和相关配套设备；
2）将4K三维电子内窥镜的排插接头连接至内窥镜图像处理主机排插接口；
3）将配件HDMI视频线缆一端连接至主机的视频输出口，另一端连接至监视器的输入口；
4）将医用脚踏开关连接到内窥镜摄像系统主机的脚踏开关接口；
5）将内窥镜摄像系统连接至电源。

再处理说明

本产品适用于低温等离子灭菌，灭菌前请先进行预处理、清洗和干燥，灭菌参数如下表所示。

序号	方法和步骤	标准模式时间
1	抽真空	4分钟
2	吸液	5秒钟
3	注入过氧化氢	4ml
4	保压	<10分钟
5	扩散	<15分钟
6	预等离子	2分30秒
7	等离子体放电	3分钟
8	取液	5秒钟
9	注入过氧化氢	4ml
10	保压	<10分钟
11	扩散	<15分钟
12	预等离子	2分30秒
13	等离子体放电	3分钟
14	抽真空、等离子、充气组合，为开门做准备（平压）	3分5秒钟